

PANASIL® KUNDENZUFRIEDENHEITSBEFRAGUNG


● Teilnehmer: 563 Panasil Produktverwender

● Dokumentationszeitraum: März/April 2021

Hauptsächlich angewandte Abformtechniken




Eingesetzte Trägermaterialien (Putty, Heavy, Medium body)

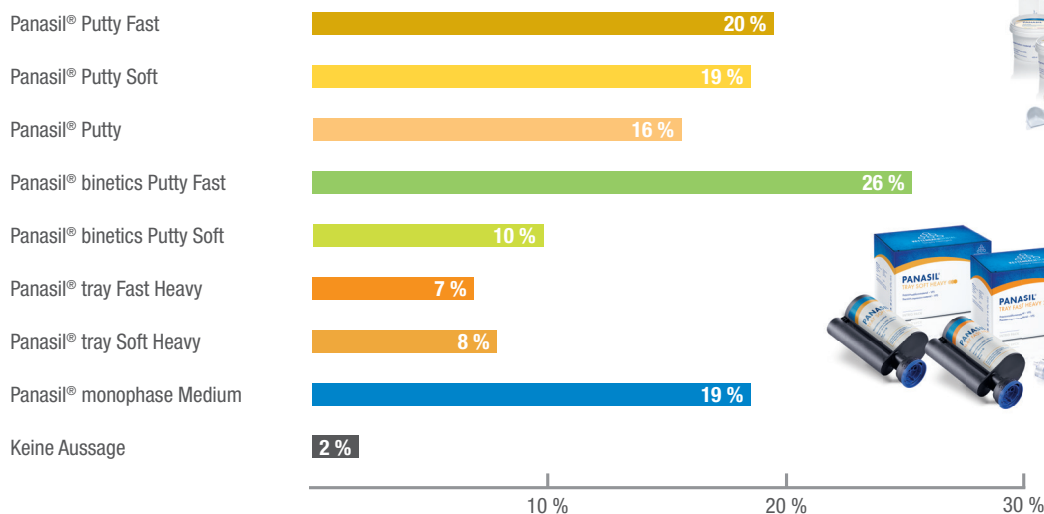


Zufriedenheit mit den Produkteigenschaften des Trägermaterials


Konsistenz (beim Kneten/Austragen)

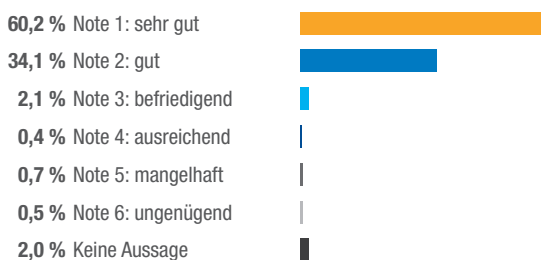


Staudruck (beim Einbringen in den Patientenmund)

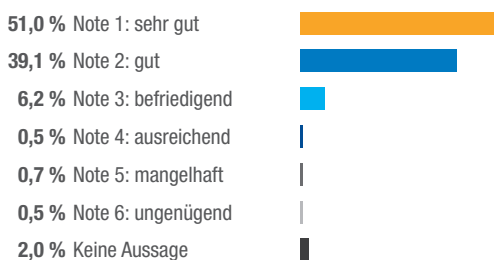


Mundentnahme

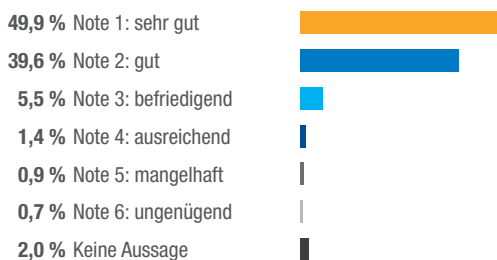

Beschneidbarkeit

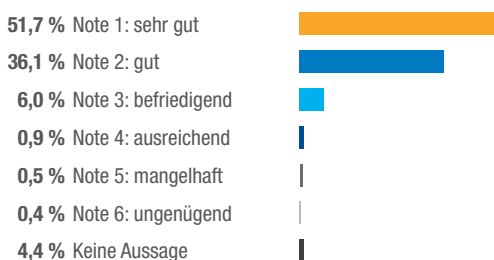


Eingesetzte Korrekturmaterien (Light body)

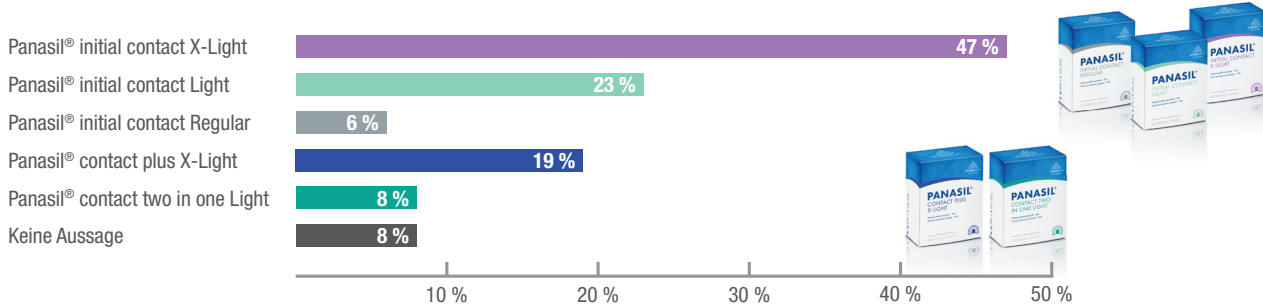


Zufriedenheit mit den Produkteigenschaften des Korrekturmaterials


Fließfähigkeit

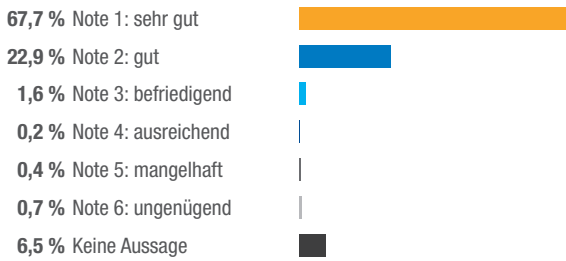


Standfestigkeit

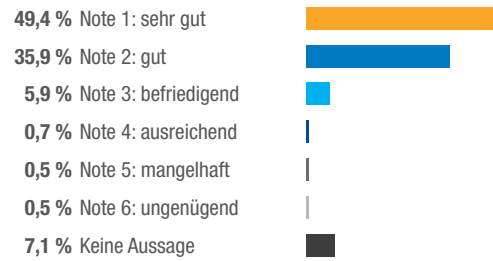


Hydrophilie (Verträglichkeit mit Blut und Speichel)

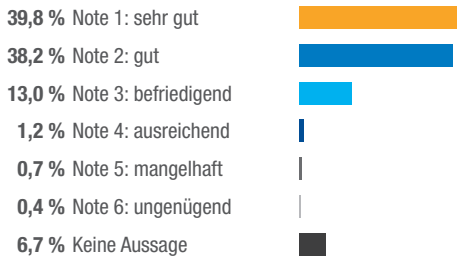

Reißfestigkeit

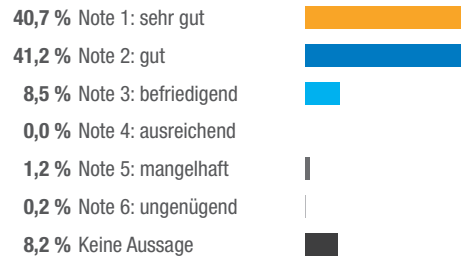

Haftverbund

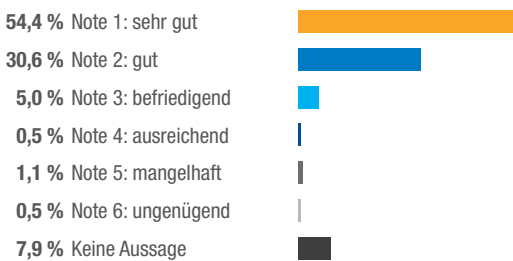

Gesamtzufriedenheit

98 %

der Teilnehmer sind **sehr zufrieden** bzw. **zufrieden** mit Panasil®

